


**Contour**  
Evolving with you

# Risultati altamente accurati<sup>1</sup>, in modo facile e semplice

**CONTOUR®XT**  
Sistema per il monitoraggio  
della glicemia

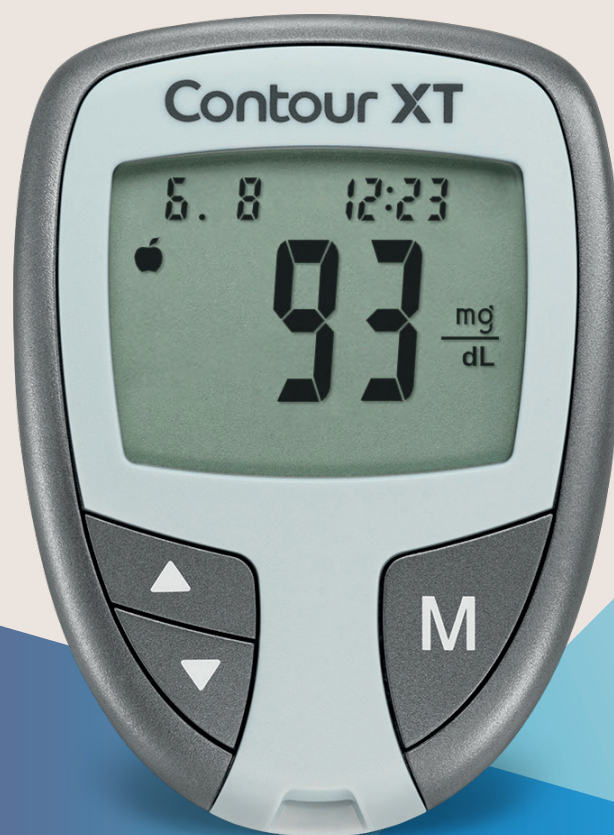

**Contour**  
Sistema per il  
monitoraggio della glicemia **XT**

  
**ASCENSIA**  
Diabetes Care

# CONTOUR®XT

## Sistema per il monitoraggio della glicemia: Risultati glicemici altamente accurati<sup>1</sup> in modo semplice e intuitivo



### Accuratezza elevata dei risultati<sup>1</sup>:

Il sistema CONTOUR®XT ha dimostrato un'accuratezza elevata<sup>1</sup> oltre i requisiti minimi degli standard di accuratezza contenuti nella norma ISO 15197:2013.<sup>2</sup>



### Facile da usare:

- Subito pronto all'uso.<sup>3</sup>
- Risultati accurati in soli 3 semplici passaggi.<sup>3</sup>



**Second-Chance®  
sampling**

### Funzione Second-Chance® sampling:

- Possibilità di riapplicare altro sangue sulla stessa striscia reattiva se la prima goccia di sangue non è sufficiente, senza pungersi nuovamente il dito<sup>3</sup>
- Riduce la frustrazione di pungersi nuovamente\*<sup>4</sup>
- Può far risparmiare fino a 100 strisce reattive all'anno<sup>†4</sup>

**Consiglia il sistema CONTOUR®XT!**

<sup>†</sup>Il 74% di 167 pazienti con diabete è frustrato, infastidito o esasperato dal dover usare una seconda striscia. Indicato in un sondaggio online su 400 operatori sanitari e pazienti con diabete negli Stati Uniti, Canada, Germania e Regno Unito come potenziale beneficio della funzione Second-Chance® sampling.<sup>4</sup>

<sup>†</sup>Spreco medio stimato dagli operatori sanitari. Dati e citazioni raccolti attraverso il sondaggio online su 400 operatori sanitari e pazienti con diabete negli Stati Uniti, Canada, Germania e Regno Unito.<sup>4</sup>

**Riferimenti:** **1.** Bernstein R et al. A New Test Strip Technology Platform for Self-Monitoring of Blood Glucose. J Diabetes Sci Technol. 2013 Sep 1;7(5):1386-99. **2.** International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems—requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2013. **3.** CONTOUR®XT User Guide, December 2016. **4.** Market Research Ascensia Diabetes Care, Hall & Partners online market research, conducted April/May 2015.

© Copyright 2020. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Second-Chance e il logo Second-Chance sono marchi commerciali e/o registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Lo strumento CONTOUR®XT e le strisce reattive CONTOUR®NEXT sono dispositivi medici diagnostici in vitro CE. Materiale ad uso esclusivo degli operatori sanitari.

Data di preparazione: Aprile 2020. Codice: G.DC.04.2020. PP-CN-XT-GBL-0006 . Codice materiale: 92000889 Ver. 06/20.

Distribuito in Italia da: Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l., Via Varesina, 162, 20156 Milano, Italia

**Contour.**  
Sistema per il  
monitoraggio della glicemia **XT**

Per assistenza tecnica contattare  
il Servizio Clienti di Ascensia Diabetes Care  
al numero verde 800-824055.

  
**ASCENSIA**  
Diabetes Care